


ASA DE POLIPECTOMIA OVAL DESCARTABLE MULTIFILAMENTO

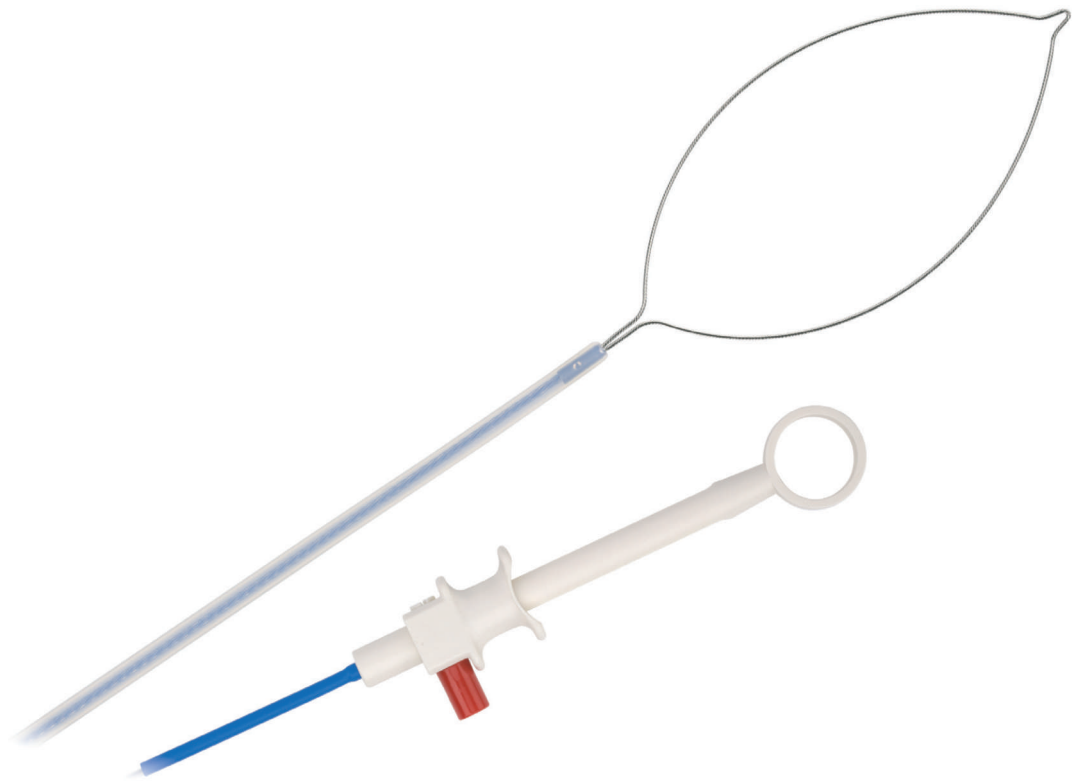

CARACTERÍSTICA

- Mango ABS de plástico con conexión de Alta Frecuencia (HF). Catéter de teflón (PTFE).
- Asa de acero inoxidable de alambre trenzado (multifilamento).
- Pasa a través del canal de biopsia de 2.8mm. del endoscopio.
- Para polipiectomía gástrica y colónica.
- Descartable.
- Esteril (EO).

Ref. No	Apertura de asa	Longitud de asa	Diámetro de catéter	Canal de trabajo	Longitud
99052011202	10mm	25mm	2.3mm	2.8mm	230cm
99052011222	15mm	30mm	2.3mm	2.8mm	230cm
99052011242	25mm	50mm	2.3mm	2.8mm	230cm
99052011232	30mm	55mm	2.3mm	2.8mm	230cm